アドバンスドアームボード
取扱説明書

1. 安全上の警告・注意

1）使用目的以外に使用しないでください。
2）本品の二次的加工をしないでください。
3）本品は浸漬しないでください。
4）本品は噴霧液で消毒、清拭しないでください。
5）本品は滅菌しないでください。
6）機器に重大な損傷を与え、患者又は使用者に重篤な障害をもたらす危険性があるため、当社指定の構成品以外の組合せで使用しないでください。
7）本品に熟練した者以外は使用しないでください。
8）機器の破損や患者の脱落を起こすおそれがあるため適用患者体重を遵守してください。

2. 製品概要と各部・付属品の名称・構造

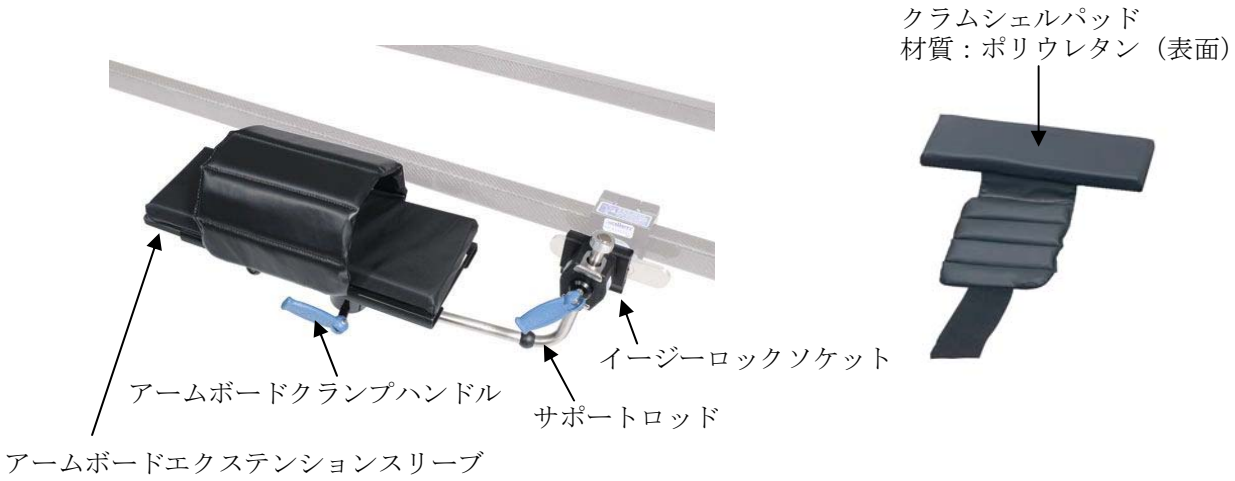

3. 一般的な使用方法とその注意事項

1）使用前に、必要に応じて消毒剤で清拭してください。
2）使用前に、患者が安全に手術台の上に位置していることを確認してください。
3）手術台のサイドレールに、適応したアドバンスドアームボードを選択してください。

> ⚠注意
> アドバンスドアームボードはクランプ一体型(イージーロックソケット)になっています。手術台のサイドレール又は手術台アクセサリーのレール幅及び厚みに適合したアドバンスドアームボード(マッケ OP 台用又は国産 OP 台用)を選択してください。

4）サイドレール上にイージーロックソケットのボールマウントが下になるようにして顎部分を噛みこませます。

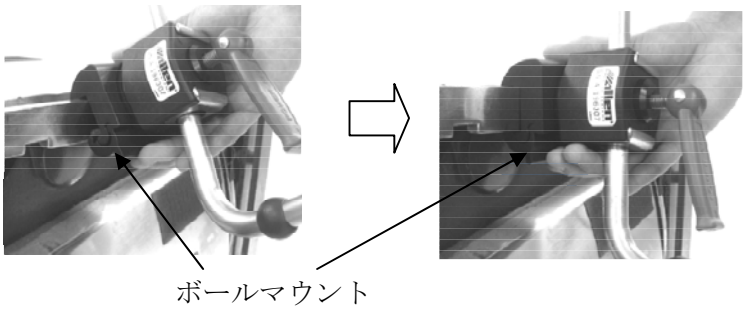

> ⚠注意
> OP 台用クランプのサイドレール又は手術台アクセサリーレールへの固定･取付は確実に行ってください。

5）イージーロックソケットのハンドルをゆるめ、①アームボードの高さ、②サポートロッドの角度を調節し、ハンドルを確実に締めて固定してください。

6）アームボードクランプハンドルをゆるめ、③サポートロッド上の位置、④アームボードの位置を調節し、アームボードクランプハンドルを確実に締めてください。

7）アームボードエクステンションスリーブを引き、⑤アームボードの長さを調節してください。

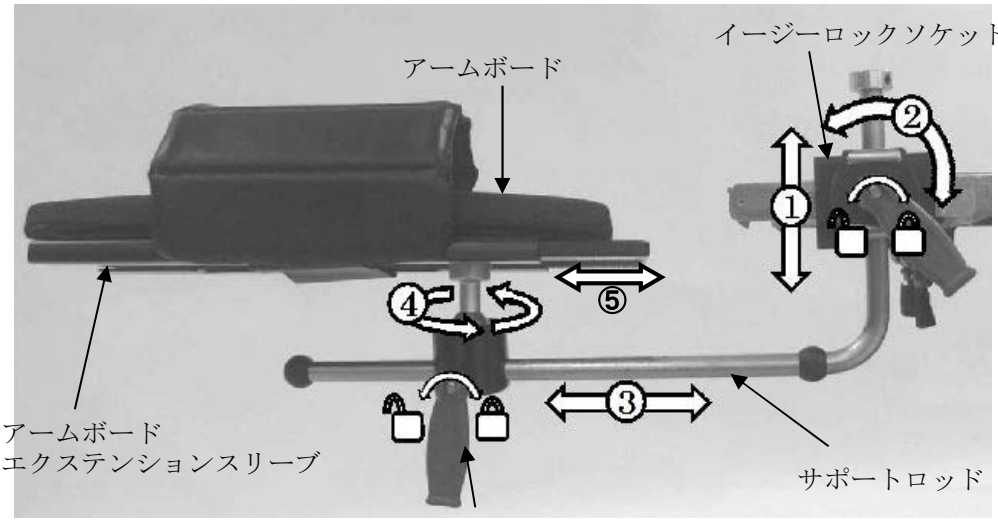

> ⚠注意
> 各ハンドルは、確実に締まっていることを確認してください。

8）アームボード下部からクラムシェルパッドのストラップを外します。

9）患者の腕をパッドの上に置きます。

10）クラムシェルパッドを点滴ライン等に注意して患者の腕に巻き、アームボードの下部でストラップを固定します。

> ⚠注意
> ① 患者の身体に負荷をかけるような動作をしないでください。
> ② 患者に無理な姿勢を取らせたり、無理な力が掛からないように装着してください。

11）使用後、クラムシェルパッドを開き、患者の腕を外します。

12）一方の手で本体を保持しながらイージーロックソケットのハンドルをゆるめ、ボールマウントの顎部底面を握って取り外します。

4. 医療機器の清掃、消耗品の交換、保管方法に関する事項

1) 清潔で良好な乾燥状態を保てる場所で保管してください。
2) 汚れが乾燥し落ちにくくなるのを防ぐため、付着した血液・体液・組織・薬品等は直ちにアルコール系消毒薬等で清拭してください。ただし、パッドはアルコール系消毒剤で清拭しないでください。
3) 漂白剤等は、使用しないでください。
4) クラムシェルパッドの変形等で固定に支障のある場合は、クラムシェルパッドを交換してください。

5. 保守点検に関する事項

1) 点検
   破損・可動部の動き等を点検してください。
2) 耐用期間［自己認証（当社データ）による］
   パッド：3 年
   パッド以外：5 年

6. 技術仕様

適用患者体重：220kg 以下
アームボード長：430～610mm

7. アフターサービスとその連絡先に関する事項

製造販売業者：村中医療器株式会社
〒594-1157　大阪府和泉市あゆみ野二丁目 8 番 2 号
TEL　0725-53-5546　　http://www.muranaka.co.jp

注文コード	品　番	商品名
623-103-15	A-70615EU	アドバンスドアームボード(マッケ OP 台用)
623-103-16	A-70615JP	アドバンスドアームボード(国産 OP 台用)

8. 保証

保証規定

1. 取扱説明書・本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で、お買い上げ日より一年以内に故障した場合、無償修理いたします。
2. 無償修理期間内でも次の場合には有償修理になります。
   (イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
   (ロ) お買い上げ後の落下などによる故障及び損傷。
   (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や電源の異常、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷。
   (ニ) 本書の提示がない場合。
   (ホ) 本書にお買い上げ日、お客様名、お買い上げ店名の記入のない場合あるいは字句を書替えられた場合。
   (ヘ) 消耗部品。
   (ト) 故障の原因が本品以外に起因する場合。
   (チ) その他取扱説明書に記載されていない使用方法による故障及び損傷。
3. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。
4. 本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。したがって、この本書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

品質保証書

このたびは、*アドバンスドアームボード*をお買い求めいただきありがとうございました。本品は厳重な検査を行い、高品質を確保しております。しかし通常のご使用において、万一不具合が発生した場合は、保証規定により、お買い上げ日より一年間は無償修理いたします。

※製品の保証は日本国内での使用に限ります。 This warranty is valid only in Japan.

※以下につきましては必ず販売店にて記入捺印をお受けください。

商品名: *アドバンスドアームボード* シリアルNo.: ご芳名	お買い上げ店名 印
ご住所 TEL. ( )	住所 TEL. ( )
	お買い上げ日 年 月 日

製造販売業者：村中医療器株式会社
〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野二丁目8番2号 TEL 0725-53-5546